



Mod de Setare | Programare Fermenter Box Model | FB-30L

Display afisaj electronic | minute, ore & grade °C

Buton (+) adauga minute, ore sau grade °C

Buton (-) scade minute, ore sau grade °C

Buton Setari | minute, ore & grade °C

Buton Pornit | Oprit alimentare aparat



Cu ajutorul butonului pentru setari puteti ajusta cu usurinta urmatoarele:

Setari | Temperatura de functionare

- programarea temperaturii (°C) la care sa lucreze dispozitivul
- pentru a seta temperatura dorita utilizati butoanele (-) si (+)
- temperatura de functionare poate fi programata numai de la : 01 °C - 80 °C !

25c

Setari | Minute de functionare


- pentru programarea minutelor utilizati butonul pentru setari
- pentru a seta durata minutelor de functionare utilizati butoanele (-) si (+)
- setarea minutelor poate fi programata numai de la : 01 - 59 minute !

45.

Setari | Ore de functionare

- pentru programarea orelor utilizati butonul pentru setari
- pentru a seta durata orelor de functionare utilizati butoanele (-) si (+)
- durata orelor poate fi programata numai de la : 01 - 96 ore !

45=

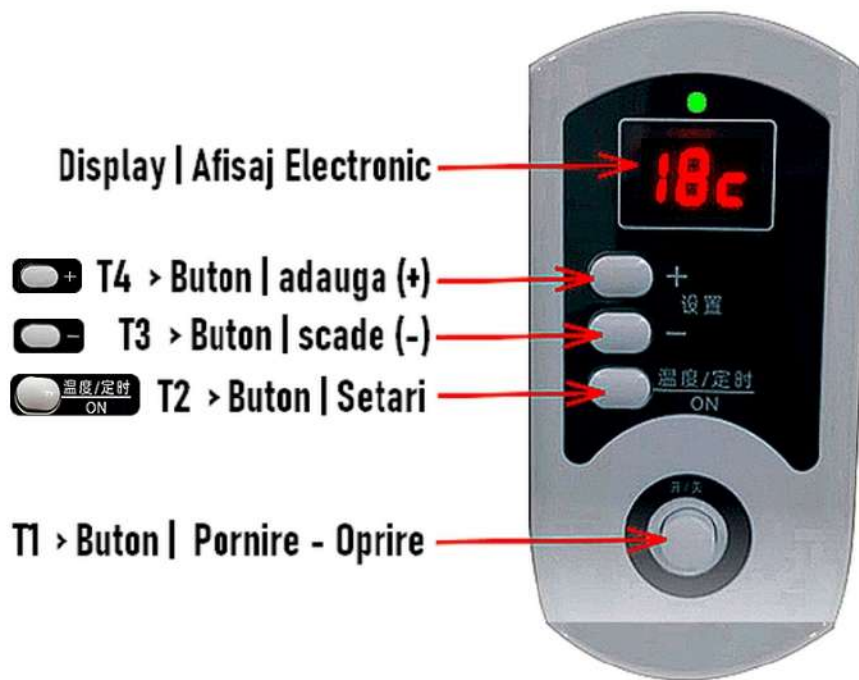

Display | Afisaj Electronic

+ T4 > Buton | adauga (+)

- T3 > Buton | scade (-)

温度/定时 ON T2 > Buton | Setari

T1 > Buton | Pornire - Opre

Simboluri | Display

01_ > Simbol setare minute !

01: > Simbol setare ore !

18°C > Simbol setare °C !

Setari | Mod de Utilizare

Conectati aparatul la priza (220v) prin intermediul stecherului din dotarea aparatului de fermentare !

Apasati butonul T1 | Buton pornire - oprire | Aparatul a fost pus in functiune | Vezi pictograma !

Display-ul rosu va arata 3 liniute rosii dupa care va indica temperatura ambientala in grade °C. **18°C**



Pentru selectarea numarului de minute dorite apasati butonul pentru setari T2-ON **温度/定时 ON** **01_**
 • Aici veti seta minutele necesare pentru functionare continua dar si temperatura dorita in grade °C !

- Apasati de 2 ori butonul T2-ON pana cand display-ul rosu indica simbolul: 01_ **01_**
- Apoi apasati butonul T3 (-) sau T4 (+) pentru a seta numarul de minute de functionare dorite !
- Display-ul rosu va pulsa cateva secunde dupa care se va stabili.
- Apoi reveniti si apasati din nou butonul T2-ON pentru a seta temperatura dorita !
- Apasati succesiv butonul T2-ON pana cand display-ul rosu indica o valoare : in grade °C
- Apasati butonul T3 (-) sau T4 (+) pentru a seta acum temperatura dorita in grade °C.
- Pentru verificarea setarii apasati butonul T4 (+) o data, acum display-ul rosu va indica temperatura setata initial, apoi va indica temperatura °C din interior masurata de catre senzorul de temperatura °C.
- Display-ul rosu va pulsa cateva secunde dupa care se va stabili si va afisa temperatura din interior !

Pentru selectarea numarului de ore dorite apasati butonul pentru setari T2-ON **温度/定时 ON** **01:**
 • Aici veti seta orele necesare pentru functionare continua dar si temperatura dorita in grade °C !

- Apasati de 2 ori butonul T2-ON pana cand display-ul rosu indica simbolul: 01_ **01_**
- Apoi tineti apasat butonul T4 (+) pana cand display-ul va afisa simbolul 01: **01:**
- Apoi apasati butonul T3 (-) sau T4 (+) pentru a seta numarul de ore de functionare dorite !
- Display-ul rosu va pulsa cateva secunde dupa care se va stabili.
- Apoi reveniti si apasati din nou butonul T2-ON pentru a seta temperatura dorita !
- Apasati succesiv butonul T2-ON pana cand display-ul rosu indica o valoare : in grade °C
- Apasati butonul T3 (-) sau T4 (+) pentru a seta acum temperatura dorita in grade °C.
- Pentru verificarea setarii apasati butonul T4 (+) o data, acum display-ul rosu va indica temperatura setata initial, apoi va indica temperatura °C din interior masurata de catre senzorul de temperatura °C.
- Display-ul rosu va pulsa cateva secunde dupa care se va stabili si va afisa temperatura din interior !

	①  Montati elementele din PVC pentru a forma un cadru dreptunghiular.	②  Pregatiti cutia de fermentare.	③  Verificati daca ati facut montajul corect iar cadrul are loc in cutia de fermentare.
④  Montati firele incalzitoare pe cadrul din interiorul cutiei de fermentare.	⑤  Introduceti cadru cu firele incalzitoare in cutie.	⑥  Fixati cadrul cu ajutorul clemelor existente in cutia de fermentare.	⑦  Pozitionati cablurile incalzitoare in mod egal in cutia de fermentare.
⑧  Cuplati cablurile incalzitoare la firele de alimentare.	⑨  Senzor de temperatura Pozitionati senzorul de temperatura spre centrul cutiei de fermentare.	⑩  Cuplati aparatul de fermentare prin intermediul stecherului la priza 220v.	Atentie ! Izolati suplimentar contactele contra umezelii !  Verificati cele doua cuplaje de alimentare pentru firele incalzitoare siliconate.
	APARAT PENTRU FERMENTARE CONTROLATA FERMENTATION BOX MODEL > FB 30Litri		

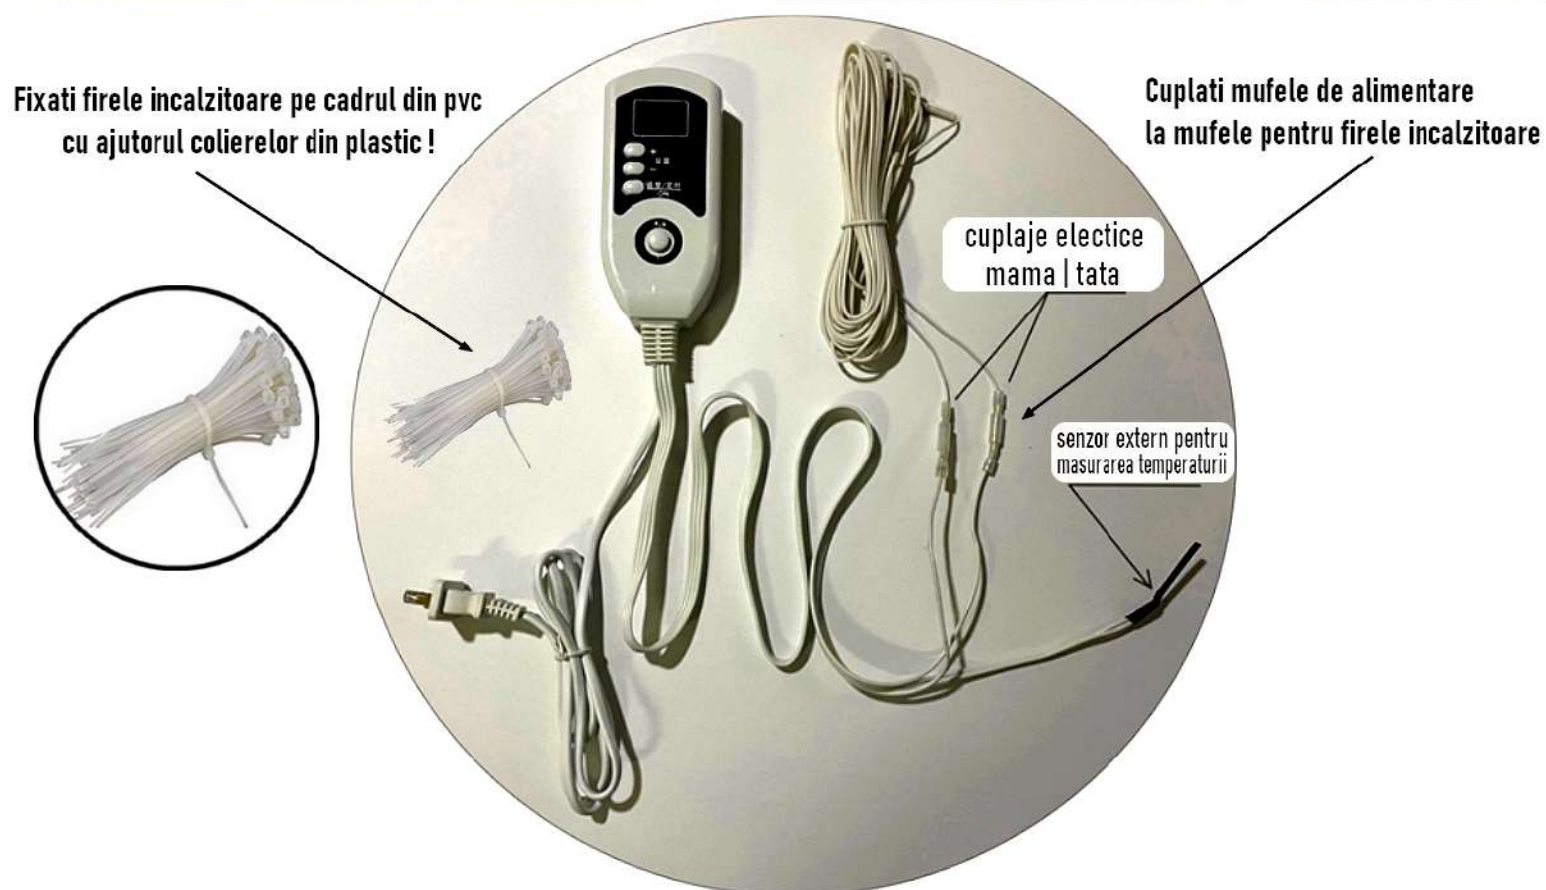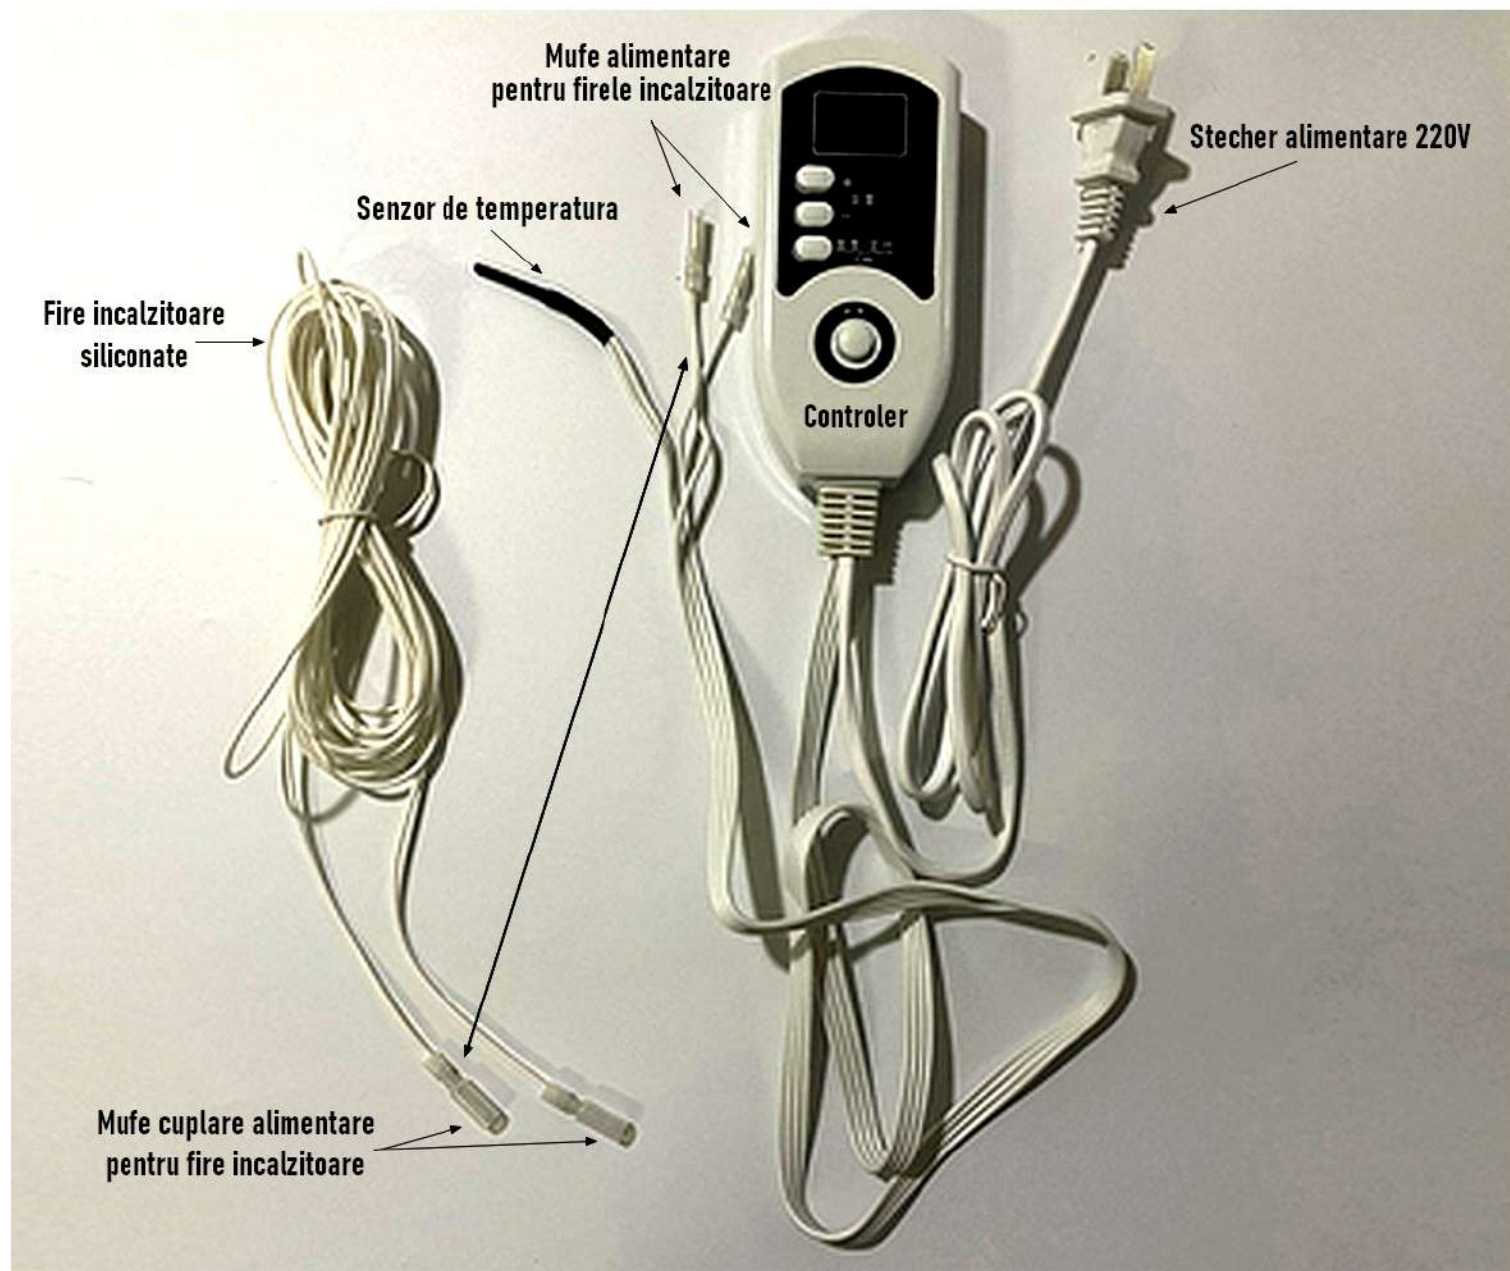

中华人民共和国
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
医疗器械产品出口销售证明
CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL
PRODUCTS

证书编号: 鲁滨药监械出 20210001 号

Certificate NO.: 20210001

产品名称: 一次性使用输液器 带针

Product(s): Fermentation box | Model: FB-30L |

规格型号: YXSY-A1-2、YXSY-A2-2、均可配带规格为 0.45×13.5 RWLB、0.5×17.5 RWLB、0.55×17.5RWLB、0.6×22 TWLB、0.7×22 TWLB、0.8×26 TWLB、0.9×26 TWLB 的静脉输液针

Model: YXSY-A1-2、YXSY-A2-2、With 0.45×13.5 RWLB、0.5×17.5 RWLB、0.55×17.5RWLB、0.6×22 TWLB、0.7×22 TWLB、0.8×26 TWLB、0.9×26 TWLB needle.

产品注册号: 国械注准 20143141832

Registration certificate(s): 20143141832

生产企业: 山东颐兴医疗器械有限公司

Manufacturer: Shandong Yixing Medical Devices Co., Ltd.

生产企业住所: 博兴县庞家镇政府驻地

Address of manufacturer: Government headquarters, Pangjia Town 256500
Boxing County, Shandong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

生产许可证号: 鲁食药监械生产许 20110050 号

Manufacturing License(s): 20110050

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。

This is to certify that the above products have been registered
to be manufactured and sold in China.

证明有效期至: 2023 年 1 月 3 日

This certification valid until: January 3rd, 2023

备注:

Remark:



EC Certificate
Directive 93/42/EEC Annex V
Production Quality Assurance
Medical Devices

Registration No.: DD 60079380 0001

Report No.: 15035757 003

Manufacturer: Shandong Yixing Medical Devices Co.,Ltd.
No. 256500 - Pangjia Town
Boxing Country, Shandong,
China

Products: Fermentation Box | Model: FB-30L

Expiry Date: 2023-10-17

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex V of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex V, section 4 of the aforementioned directive. For placing on the market of class IIb and class III devices covered by this certificate an EC type-examination certificate according to Annex III is required.

Effective Date: 2020-07-15

Date: 2020-07-15



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the identification number 0197.